MECTRON PROPHYLAXE
GLÄNZENDE RESULTATE DANK PERFEKTER ABSTIMMUNG



MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN PASSEND


PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{L}
PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{M}

Entfernt sanft und effektiv supragingivalen Biofilm und Verfärbungen von der Zahnoberfläche

INDIKATIONEN:

- Entfernen von extrinsischen Verfärbungen durch Tabak, Wein, Tee und Farbstoffe
- Reinigen von Fissuren und Kavitäten
- Behandlung von kieferorthopädischen Patienten



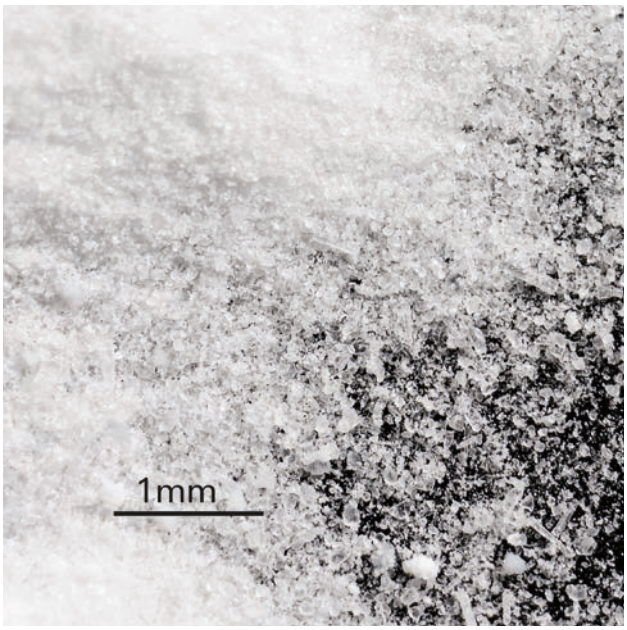

Form der Natriumbikarbonat-Partikel vergrößert auf 1 mm

PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{L} + SOFT^{M}

- Basierend auf Natriumbikarbonat
- Durchschnittliche Partikelgröße 55 µm
- Erhältlich in zwei Geschmacksrichtungen: Lemon und Minze
- Verpackung: 4 Flaschen mit je 250 g
- Artikel Nr. 03140030 - SOFT^{L}

  Artikel Nr. 03140026 - SOFT^{M}

FÜR DIE BEDÜRFNISSE IHRER PATIENTEN


PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ – GLYCINE POWDER

Entfernt schonend supra- und subgingivalen Biofilm

INDIKATIONEN:

- Sanftes Entfernen von Verfärbungen
- Detoxifikation parodontaler Taschen
- Parodontale Erhaltungstherapie
- Implantpflege und behandeln von Peri-Implantitis
- Reinigen kieferorthopädischer Brackets
- Schonendes Reinigen restaurativer Materialien
- Minimal invasiv auf freiliegenden Zahnhälsen und Dentin
- Reduziert Belastung mit kolonie-bildenden Bakterien
- Kann erfolgreich zur Behandlung aller Arten von Patienten eingesetzt werden



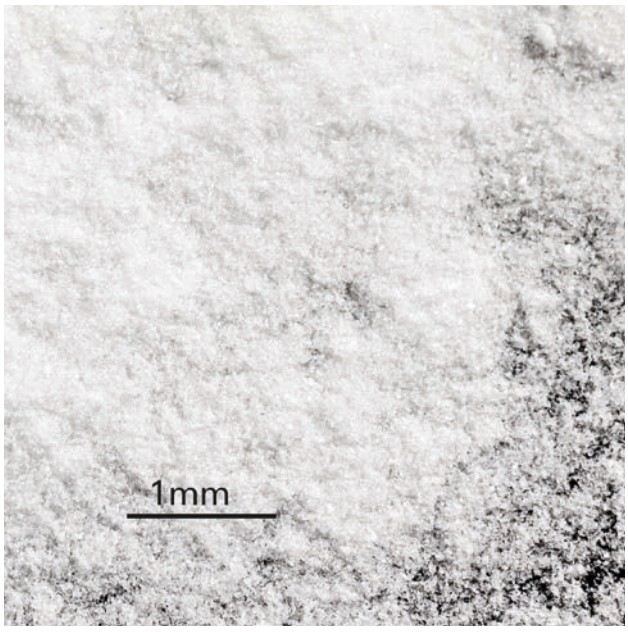

Form der feinen, minimal invasiven Glyzin-Partikel vergrößert auf 1 mm

PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE⁺ – GLYCINE POWDER

- Basierend auf Glyzin
- Durchschnittliche Partikelgröße 25 µm
- Süßlicher Geschmack
- Verpackung: 2 Flaschen mit je 160 g
- Artikel Nr. 03140021

DIE EVOLUTION DER PROPHYLAXE



STARJET

turbinenadaptiertes Pulverstrahlgerät für die supra- und subgingivale Anwendung



COMBI *touch*

Ultraschalleinheit und Pulverstrahlgerät in einem

INDIKATIONEN	SOFT^{L} SOFT^{M}	SENSI-TIVE^{+}	INDIKATIONEN	SOFT^{L} SOFT^{M}	SENSI-TIVE^{+}
Entfernung von supragingivalem Biofilm	●	●	Behandlung der Peri-Implantitis	○	●
Entfernung von extrinsischen Verfärbungen	●	○	Reinigen von Brackets	●	●
Entfernung von subgingivalem Biofilm	○	●	Reinigen restaurativer Materialien	○	●
Detoxifikation von parodontalen Taschen	○	●	Pflege von Füllungen	○	●
Pflege von Implantatoberflächen	○	●			

Referenzen:

- Bühler, Julia & Amato, Mauro & Weiger, Roland & Walter, Clemens. (2015). *A systematic review on the effects of air polishing devices on oral tissues.* International Journal of Dental Hygiene. 14. 10.1111/idh.12120.
- Hongsathavij, Rosalin & Kuphasuk, Yosvimol & Rattanasuwan, Kanyawat. (2017). *Clinical comparison of the stain removal efficacy of two air polishing powders.* European Journal of Dentistry. 11. 370-375. 10.4103/ejd.ejd_152_17.
- Poormoradi, Banafsheh & Tamasoki, Shahrzad & Shahbazi, Armaghan & Hooshyarfard, Amirarsalan & Vahdatinia, Farshid & Behgozin, Faeze & Tapak, Leili. (2018). *The comparison of two professional prophylaxis systems in plaque removal and debonding of orthodontic brackets.* Journal of Indian Society of Periodontology. 22. 414. 10.4103/jisp.jisp_387_17.

Vertrieb durch: Bien-Air Dental SA,
Länggasse 60, 2500 Bienne 6, Tel +41 (0)32 344 64 25,
info@mectron.ch, www.mectron.ch

PROPHYLAXIS POWDER SOFT^{L} und SOFT^{M} sind registriert und hergestellt von SPEIKO - Dr. Speier GmbH, Walther-Rathenau-Str. 59, 33602 Bielefeld, Germany
PROPHYLAXIS POWDER SENSITIVE^{+} ist registriert und hergestellt von PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Germany

© Copyright Mectron S.p.A., Carasco, Italien
Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder und Grafiken der mectron-Broschüren unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Ohne schriftliche Zustimmung dürfen die Inhalte nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

mectron
medical technology

Smart Dentist AG
Verenastrasse 4b, 8832 Wollerau +41 44 726 20 20 info@smartdentist.ch www.smartdentist.ch
SmartDentist

© mectron DEFLY0092DECH-2308